

# Monatsbericht

## Oktober 2021

### Geräteinformationen

Gerätetyp	P510
Seriennummer	4002000020
Software-Version	V 7.04
Gesamtbrennstunden des Ofens	2300 h
Gesamtbrennstunden der aktuellen Heizmuffel	1467 h
Garantierte Restlebensdauer der Heizmuffel	33 h
Vakuumstunden	2 h
Letzte Kalibrierung	2021-08-08

### Letzte Meldungen

Info 1800: Es ist kein USB Memory-Stick vorhanden.

Hint 111: Die max. Anzahl an Protokolleinträgen wurde erreicht. Eine nochmalige Protokollierung wird bestehende Einträge löschen / überschreiben.

Error 1301: Fehler bei der Kalibration.

### Status


Ihre Vakuumwerte sind in Ordnung.

Die Heizmuffel in Ihrem Ofen hat eine Restlebensdauer von 33 Stunden. Der Orientierungswert für die garantierte Lebensdauer der Heizmuffel beträgt 1500 Stunden. In Abhängigkeit Ihres Nutzerverhaltens über die vergangenen vier Wochen wird die Heizmuffel das Ende der empfohlenen Lebensdauer in 14 Wochen erreichen. Möglicherweise wird danach die Qualität des Brennergebnisses negativ beeinflusst. Führen Sie bitte ab sofort regelmässig einen Heizungstest (siehe Bedienungsanleitung) durch, um die Heizmuffel-Qualität zu überprüfen. (Dauer ca. 7 Min.) Bei zu heissem Ofen wird eine fehlerhafte Heizmuffelqualität angezeigt. Beim Unterschreiten einer Hezelementqualität von 50% wird ein Wechsel des Heizmuffel empfohlen. Dies kann nur von Mitarbeitenden der Gerätereperatur von Ivoclar Vivadent durchgeführt werden. Kontaktieren Sie dazu unsere Service Hotline.

Ihr Gerät ist kalibriert.


Ihre Software ist veraltet. Die neueste Version ist V 7.11. Durch ein Software-Update werden Software Fehler behoben sowie Optimierungen und Erweiterungen zur Verfügung gestellt. Bitte führen Sie ein Softwareupdate (siehe Bedienungsanleitung) durch, um die Stabilität und Qualität ihres Ofens beizubehalten.

## Brennvorgänge

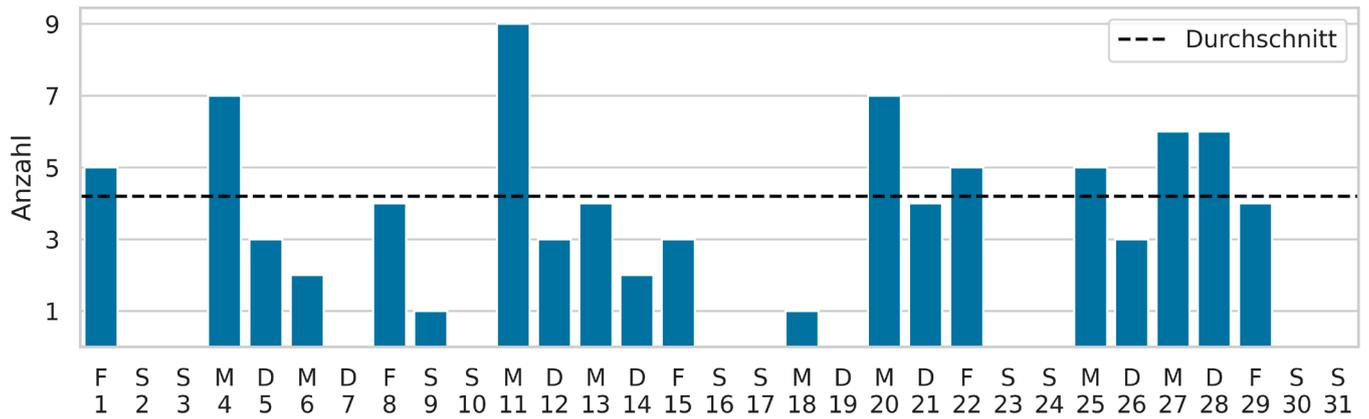


Anzahl der Brennvorgänge pro Tag als Balkendiagramm (inkl. Anzahl der durchschnittlich durchgeführten Brennvorgänge).

## Vakuumwerte

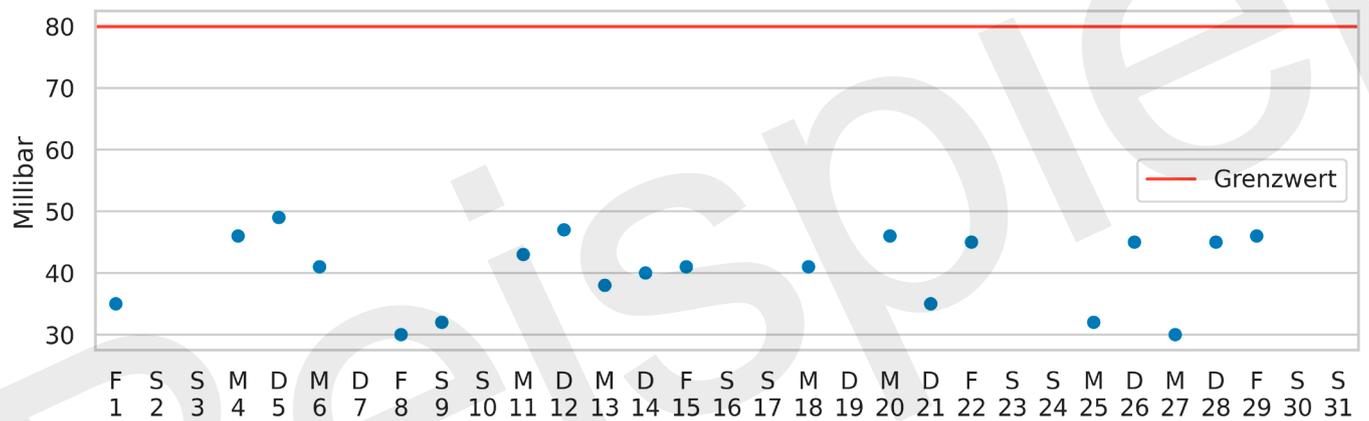

Erreichte Vakuumtiefstwerte pro Tag (inkl. Anzeige des Referenzwertes von Ivoclar Vivadent – 80 mbar).

## Brennvorgänge nach Materialtyp

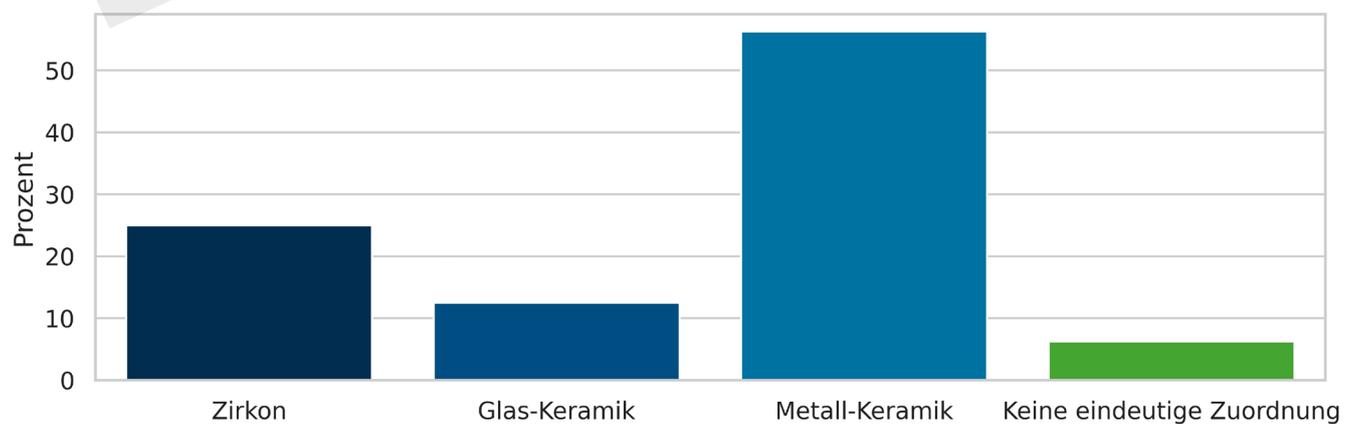

Aufteilung der durchgeführten Brennvorgänge nach Materialtyp während des Monats als Balkendiagramm.